



ЗАВОД ЗА
БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ
ЕКОЛОГИЈУ

PIB: 102142866
Matični broj: 07011563
Šifra delatnosti: 8690
Beograd, Trebevička 16
Centrala: 011/3054 000
Faks: 011/3054 044
E-mail: zavod@biocidi.org.rs
Broj žiro računa:
310- 216424-65 NLB Banka

PRAVILO ODLUČIVANJA PRI IZDAVANJU IZJAVE O USAGLAŠENOSTI

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja primenjuje binarni sistem jednostavnog odlučivanja, odnosno „podeljeni rizik“ pri donošenju odluka za rezultate ispitivanja koji su bliski granicama odlučivanja, odnosno graničnim vrednostima.


Sistem odlučivanja koji primenjuje Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja uzima u obzir rezultat ispitivanja sa proširenom mernom nesigurnosti (ILAC-G8:09/2019, tačka 4.2.1) koja se navodi u izveštaju o ispitivanju, dok je granica donošenja odluka istovremeno navedena granična vrednost u navedenoj specifikaciji.

Shodno gore navedenom laboratorija daje izjavu o usaglašenosti prema sledećem pravilu odlučivanja:

	Opis	Izjava o usaglašenosti
Slučaj I	dobijeni rezultat ispitivanja sa proširenom mernom nesigurnošću nalazi se unutar granica specifikacije	Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja analiziranih parametara uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u odgovarajućem Pravilniku/Uredbi/Specifikaciji proizvoda
Slučaj II	dobijeni rezultat ispitivanja nalazi se unutar granica specifikacije, a interval proširene merne nesigurnosti prelazi granice specifikacije	Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja analiziranih parametara uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u odgovarajućem Pravilniku/Uredbi/Specifikaciji proizvoda ali se ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95%
Slučaj III	dobijeni rezultat ispitivanja nalazi se izvan granica specifikacije, a deo intervala proširene merne nesigurnosti se nalazi unutar granica specifikacije	Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja analiziranih parametara uzorak je NEUSAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u odgovarajućem Pravilniku/Uredbi/Specifikaciji proizvoda, ali se ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95%
Slučaj IV	dobijeni rezultat ispitivanja kao i interval proširene merne nesigurnosti se nalazi izvan granica specifikacije	Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja analiziranih parametara uzorak je NEUSAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u odgovarajućem Pravilniku/Uredbi/Specifikaciji proizvoda



Slika 1. Pravilo odlučivanja sa prizanim rezultatima ispitivanja i priladajućom proširenom menom nesigurnošću

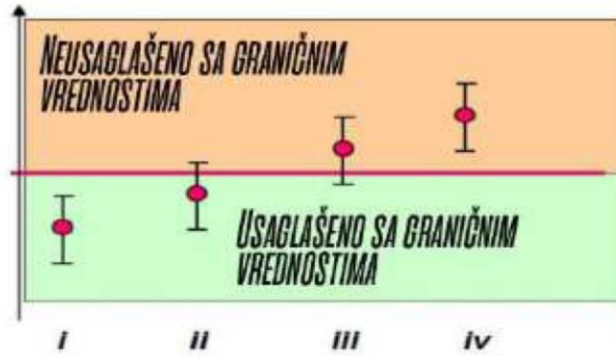

Pravilo odlučivanja pri izdavanju izjave o usaglašenosti predstavlja sastavni deo ZBME.LX.P.01-01 Zahteva za ispitivanje. Ukoliko klijent zahteva drugo pravilo odlučivanja u vezi sa izjavom o usaglašenosti isto mora navesti u ZBME.LX.P.01-01 Zahtevu za ispitivanje.